



**REGIONAL**

1

Varginha – MG, 11 de dezembro de 2025.

**Ofício/Diretoria/HRSM nº 469/ 2025.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha,

O Hospital Regional do Sul de Minas, inscrito no CNPJ sob o nº 25.863.390/0001-54, situado na Av. Rui Barbosa, nº 158, Centro, Varginha – MG, vem, por meio deste, atendendo à solicitação de informações realizada através do Ofício nº 101/2025/SG, e o Requerimento Nº 239/2025, encaminhar os esclarecimentos abaixo expostos, respondendo os questionamentos realizados:

1. O aparelho de Raio-X do prestador de serviços contratado pelo Hospital Regional está em pleno funcionamento, e em condições de ofertar o atendimento necessário aos nossos pacientes, conforme comunicado em anexo;
2. O equipamento necessitou de ser paralisado no dia 28 de outubro de 2025, às 11h10, devido à avaria do tubo de Raio-X. A partir de então foram reunidos esforços imediatos para constatação e suprimento do problema, o qual foi devidamente solucionado no dia 03 de novembro de 2025, dia em que ele voltou a ser colocado em funcionamento.
3. E 4 - Respondidas acima.
4. Para atender os pacientes que do atendimento necessitaram foram providenciados os remanejamentos para unidades parceiras do hospital, suprimindo as respectivas demandas.
5. Contratos com empresas que realizam a manutenção dos equipamentos são celebrados a fim de mitigar problemas como o ocorrido.

Diante do exposto ilustríssimo Edil, na certeza de ter atendido ao requerido, junta-se o comunicado do prestador de serviços com os esclarecimentos mencionados, e coloca-se à disposição para o que se fizer necessário, renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Hospital Regional do Sul de Minas**

JOAO CARLOS OTTONI  
ADELL:94688923791

Assinado de forma digital por JOAO  
CARLOS OTTONI  
ADELL:94688923791  
Dados: 2025.12.11 12:16:39 -03'00'

**João Carlos Ottoni Adell**

**Presidente do Conselho Diretor**

Ilmo. Sr.

**Robson Souza de Almeida**

**Secretário Geral da Câmara Municipal de Varginha**

**Pça. Governador Benedito Valadares, nº 11, Centro**

**CEP: 37.002-020 – Varginha/MG**

HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA - 72941 DE 17/10/73 - MJ - Nº 27.615-65 - CNPJ: 25.863.390/0001-54

Av. Rui Barbosa, nº 158 - Centro - CEP: 37.002-140 -

Varginha/MG Fone: (35) 3690-2800 -2823 - hrsm@hrsm.com.br

## Comunicado Oficial: Restabelecimento e Melhorias no Setor de Radiologia

### COMUNICADO

**Assunto:** Pleno Funcionamento do Equipamento de Raio-X e Ações de Melhoria na Rede Elétrica

Prezados(as) Usuários(as),

A **D-RADIO IMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA**, vem através deste, informar o pleno restabelecimento e funcionamento do equipamento de Raio-X da Unidade desde o dia **03 de Novembro de 2025**.

O equipamento apresentou uma interrupção em seu serviço no dia **28 de Outubro de 2025, às 11h10**, devido à avaria do **tubo de Raio-X**. Imediatamente, o suporte técnico foi acionado.

### Detalhamento da Manutenção e Logística de Peças

O tubo avariado, que estava em funcionamento há muitos anos, não se encontrava disponível no estoque do fornecedor de manutenção por ser um modelo antigo. As manutenções preventivas realizadas no equipamento não preveem problemas dessa magnitude. A peça foi localizada e adquirida em um fornecedor diretamente da **Indonésia**, despachada via frete aéreo em **29/10/2025** e chegou ao país em **31/10/2025**.

Durante o processo de substituição, constatou-se que o **cabo de alta tensão** que alimenta o tubo também estava danificado, exigindo troca imediata. Por ser um modelo específico e de urgência, a peça foi providenciada e a substituição foi concluída em **03/11/2025**, data em que o equipamento foi normalizado.

### Reafirmação sobre a Urgência e Complexidade Técnica

Reiteramos que problemas dessa magnitude são tratados com a máxima urgência. Contudo, por se tratar de equipamentos com componentes específicos, a manutenção, mesmo que ocorra de forma imediata, requer que a substituição dessas peças ocorra de maneira **escalonada, programada e com a máxima cautela**, respeitando os prazos logísticos e técnicos de fornecimento internacional.


### Ações de Mitigação de Riscos Elétricos

Reconhecemos que o setor já havia enfrentado problemas elétricos, como o dano em um componente (placa D8) do gerador de alta tensão da outra sala de RAIO-X (Sala 02). A mesma também já está em pleno funcionamento.

Diante disso, a Administração Hospitalar e a Gestão da D-RADIO realizaram verificações e melhorias na rede **elétrica** no último mês para mitigar fatores de natureza elétrica:

- Instalação de **Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)** e **Relés Falta de Fase** em todas as salas de Raio-X e Tomografia.
- Instalação de **voltímetros** para medição e monitoramento da tensão da sala em tempo real.

Quadro elétrico antigo sem as devidas proteções (a esquerda) e novo quadro com rele falta de fase e voltímetro (a direita)

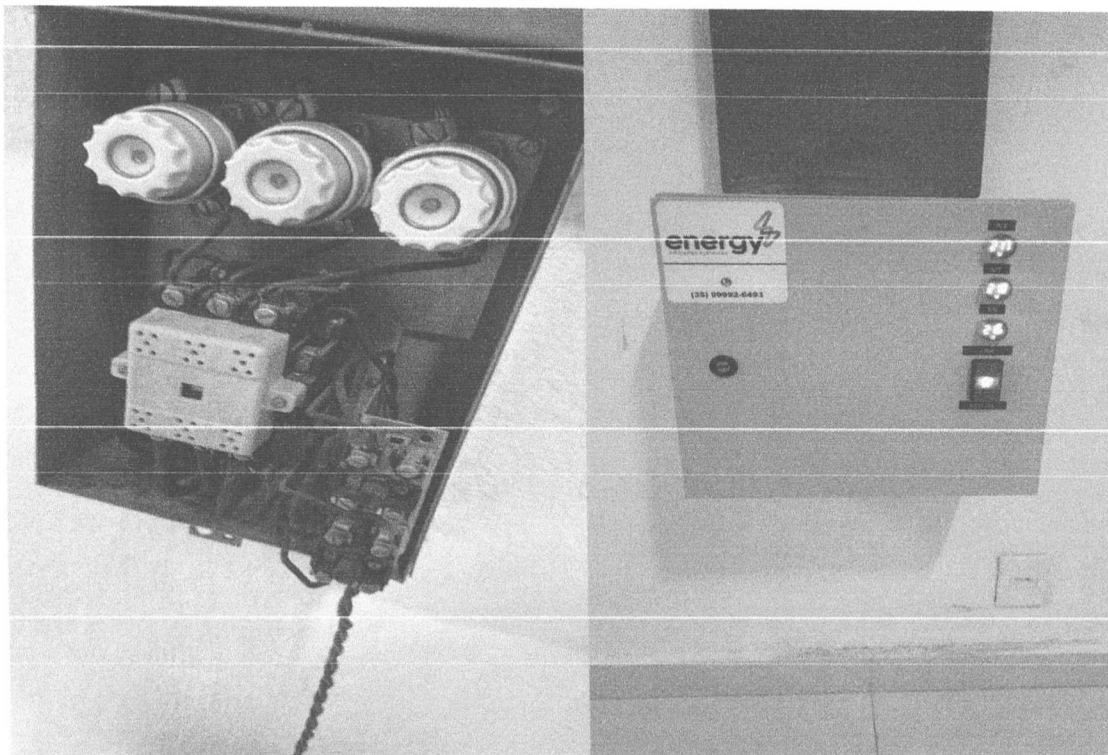

Quadro elétrico antigo sem as devidas proteções (a esquerda) e novo quadro com rele falta de fase e voltímetro (a direita)

Os pacientes foram realocados para outras unidades conforme urgência das demandas.

Agradecemos a compreensão de todos durante o período de indisponibilidade e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e a qualidade dos nossos serviços de diagnóstico por imagem.

Atenciosamente,

**Coordenação D-RADIO Imagem**

**Varginha, 24 de Novembro de 2025.**



OFÍCIO Nº 101/2025/SG

Varginha, 6 de novembro de 2025.

À Senhora  
Mariana Maciel Ferreira  
Diretora Geral do Hospital Regional  
Av. Rui Barbosa, 158 - Centro  
Varginha - 37002-140

**Assunto: Encaminha Requerimento**

Prezada Senhora,

Encaminhamos, para as providências necessárias, cópia do Requerimento 239/202, de autoria do vereador Marco Antônio de Souza - Marquinho da Cooperativa, aprovado pelo Plenário desta Câmara Municipal. O Requerimento solicita informações referentes ao aparelho de Raio-X do Hospital Regional, que segundo informações recebidas encontra-se inoperante.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

ROBSON SOUZA DE ALMEIDA

Data: 06/11/2025 13:50:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON SOUZA DE ALMEIDA  
Secretário-Geral da Câmara



Documento Assinado  
DIGITALMENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG


Praça Governador Benedito Valadares, nº 11, Centro. 37002-020, Varginha – MG

E-mail: [camara@varginha.mg.leg.br](mailto:camara@varginha.mg.leg.br) | Site: [varginha.mg.leg.br](http://varginha.mg.leg.br) | (35) 3219-4757

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com a Resolução nº 11/2023



Requerimento n. 239/2025

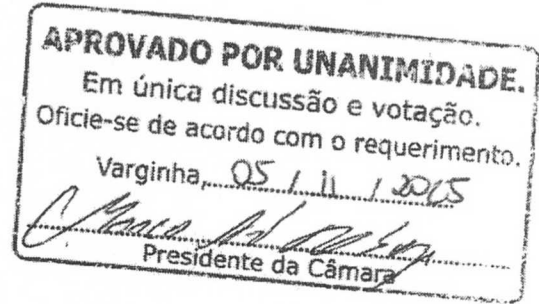

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador subscritor requer a Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde e ao Hospital Regional do Sul de Minas-HRSM, solicitando as seguintes informações sobre o aparelho de Raio-X do Hospital Regional, que segundo informações recebidas encontra-se inoperante:

1. O aparelho de Raio-X do Hospital Regional encontra-se realmente sem funcionamento?
2. Qual o motivo da paralisação do equipamento?
3. Desde quando o aparelho está inoperante?
4. Há previsão para o conserto, substituição ou restabelecimento do serviço?
5. Os pacientes estão sendo encaminhados para realizar o exame em outro local? Se sim, onde e de que forma está sendo feito esse encaminhamento?
6. Quais medidas estão sendo adotadas para evitar que situações semelhantes ocorram novamente?

#### JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se faz necessário diante das diversas reclamações recebidas por este vereador de munícipes que estão buscando atendimento e não conseguem realizar o exame de Raio-X no Hospital Regional, devido à informação de que o aparelho se encontra sem funcionamento.


Tal situação tem gerado grande preocupação e transtornos à população, especialmente àqueles que necessitam com urgência do exame para dar continuidade aos seus tratamentos médicos. O presente pedido tem como objetivo garantir transparência e assegurar que a população receba o atendimento digno e eficiente que merece.


Diante dos fatos expostos, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 5 de novembro de 2025

  
MARCO ANTÔNIO SOUZA - Marquinho da Cooperativa  
Vereador

  
JOÃO MARTINS RIBEIRO  
Vereador - DC

  
EDUARDO BENEDITO OTTONI FILHO  
DUDU OTTONI  
Vereador - AVANTE

  
Rogério Bernardo Bueno  
ROGÉRIO BUENO  
Vereador - PV

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG  
Praça Governador Benedito Valadares, nº11, Centro. 37002-020, Varginha - MG  
E-mail: [camara@varginha.mg.leg.br](mailto:camara@varginha.mg.leg.br) | Site: [varginha.mg.leg.br](http://varginha.mg.leg.br) | (35) 3219-4757